




20

2020 2020

201

01

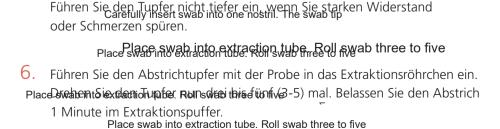

CarefunchenserSieradentJupeero3trial Walsvardansen Sie den Abstrichtupfer einige Sekunden

im Nasenloch. Wiederholen Sie den Vorgang mit demselben Tupfer im

Carefully insert swab into one nostril. The swab tip anderen Nasenloch. VORSICHT: Dies kann sich unangenehm anfuhlen.

Place swab into extraction tube. Roll swab three to five

2

Invalid:



Pinch extraction tube with fingers and remove Pinch extraction tube with fingers and remove the

Niedersächsisches

Pinelinekowneetienewithdingeneanthethemipisterium

Pinch extraction tube with fingers and remove the

Drückestaliendas Extratotions töhschere exittation Fürgern zusammen und entfernen dahach so our wernoulle wie ussand work Abstrachtupfer, während Sie den Abstrichtupfer herausziehen und auf ein Einwegtuch legen. Instantal the 2002 zlepconte the semple extraction tube

Setzen Sindia AbdezkeappermithTranfaufanta auf das Extraktionsröhrchen.

- the kit components to room temperature before Bring the kit comportents to room temperature perore Bring the kit components to room temperature perore Öffnen Sie den Beuter und enthennem Sie die restkassette. 9
 - Legen Sie die Testkassette auf eine flache und ebene Oberfläche. Brittering we kurgemeinen einem temperaturer beiere VORSICHT: Nach dem Offnen muss die Testkassette sofort verwendet werden.
 - Bring the kit components to room temperature before
- 10. Drewen beedbadtan tibe and add 3 drops about 75 / 10 der Testminheurusicien Richard wertigfunge Sie das Extraktionsröhrchen leierus vor in der Beiten auf der Beiten

VORSICHT: Die Bildung von Luftblasen in der Probenvertiefung (S) ist zu vermefenstellteringenstigen die gestellte bestellen die eine

Read the results at 15-20 minutes 11. Da**s** te unschland die unschland die eine state in sta

nes the incuteral for the thirteen sal protocol.

Positive: Yes Read the results at 15-20 minutes. Deutuno

E	С Т	Ст	

10

10

10

10

te the

the

he

you

Read the results at 15-20 minutes. regulations and biohazard waste disposal protocol. Wenn innerhalb von 15-20 Minuten zwei Farblinien – eine Farblinie im Kontrollbereich (C) und

Negative im Testbereich (T) - arscheinen wastedispost gültig und positiv. Das Ergebnis ist als positiv zu werten, egal wie schwach die Farblinie im Testbereich (T) zu sehen ist. Ein positives Ergeb Reality eine gleichzeitige Infektion mit anderen Krankheitserregern nicht aus.

out

out

tip

katout

Invalid lingation : С Т

15-20 min

Wenn innerhalb von 15-20 Minuten eine Farblinie im Kontrollbereich (C) erscheint, jedoch im Testbelkekking keine Farblinie zu sehen ist, so ist der Test gültig und negativ. Ein negatives Ergebnis schließt eine virale Infektion mit SARS-CoV-2 nicht aus und sollte bei Verdacht von COVID Manurch molekulardiagnostische Methoden bestätigt werden.

i	_		_	
		С		c
		т		Т

🗕 Unaültig:

7.

8.

Wenn innerhalb von 15-20 Minuten keine Farblinie im Kontrollbereich (C) erscheint, so ist der Test ungültig. Wiederholen Sie den Test mit einer neuen Testkasser Bistributori verlagen einer Techno

		,
	Support Hotline Em Support Hotline Emaile Support Ny Work (Ny Web : w Web: w	ail: support@dein-co support@dein.co Wheek algorithe set ww.dein-corona-selbs
	And Hoteline	God Englischport We WeWWWWEE
	Support Hotline Distributor:	Email: support@de
Corona-Schnelltests des Herstellers Xiamen Boson Biotech Co., Ltd.	Support Hotline	Email: support@dei Web운\\\\

uthorized

five

o five

efive



Niedersächsisches Kultusministerium

Erste-Hilfe-Maßnahmen

→ Nach Hautkontakt

Waschen Sie die Haut mit Wasser ab – sofern Irritationen oder Unwohlsein auftreten, konsultieren Sie einen Arzt/eine Ärztin.

→ Nach Augenkontakt

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit viel Wasser spülen. Kontaktlinsen entfernen. Unverletztes Auge schützen. Auge weit geöffnet halten beim Spülen. Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.

→ Bei Schlucken / Einnehmen

Waschen Sie den Mund mit Wasser aus – sofern Irritationen oder Unwohlsein auftreten, konsultieren Sie einen Arzt/eine Ärztin.